

Bulletin d'information – semaine 25 (15 – 22 juin 2020)

BILAN D'ACTIVITÉ

249 566

Nombre d'analyses sur les 7 derniers jours

4 104

Positifs sur les 7 derniers jours

1.64%

Taux de positivité

241 758

Nombre pour une semaine avant


3 161

Positifs pour une semaine avant

1.31%

Positivité une semaine avant

Carte du nombre d'analyses pour 100 000 habitants sur les 7 derniers jours

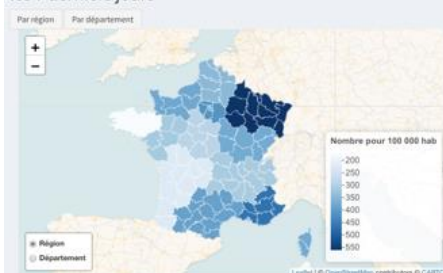

Carte du taux de positivité sur les 7 derniers jours



Evolution du nombre de tests d'une période à l'autre



BILAN DES TENSIONS

Principales tensions remontées

Action de la cellule tests

Prélèvement

Tensions locales sur les écouvillons

- **Stocks** : 414 354 (source DREES)
- **3,4 %** des laboratoires déclarent au moins une tension sur une référence d'écouvillons

Des demandes de réassort d'urgences peuvent être faite : covid19-log-distrib@sante.gouv.fr

EPI

Type

Tension

Surblouses

Tension moyenne

Gants

Tension importante

Chir. / FFP2

Pas de tension / faible tension

Réactifs en tension parmi les plus déclarés

* **Représentation** en % des établissements ayant signalé le réactif

** **Tension** en % des lignes de production déclarées en tension sur ce kit.

Période : 8-22 juin

Type

Modèle

R*

T**

Système intégré
(N = 186)

Xpert Xpress (Cepheid)

46 %

18 %

Novodiag (Mobidiag)

7 %

0 %

Viasure (Certest)

7 %

8 %

Amplification
(N = 140)

Allplex (Eurobio)

15 %

0 %

BD Max (BD)

10 %

36 %

Superscript III (TF)

7 %

0 %

Argene (BioMérieux)

6 %

0 %

Extraction
(N = 126)

TNA-3 (BD)

25 %

18 %

EMAG (Biomérieux)

11 %

0 %

STARmag (Seegene)

9 %

0 %

EZ1 (Qiagen)

7 %

0%

INFORMATIONS SUR LA SEROLOGIE

37 852

Nombre d'analyses


4 118

Positifs


10.88%

Taux de positivité

Réalisé pour 100 000 habitants

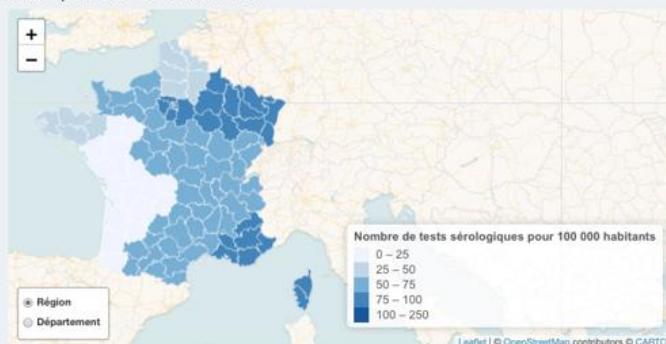

Taux de positivité

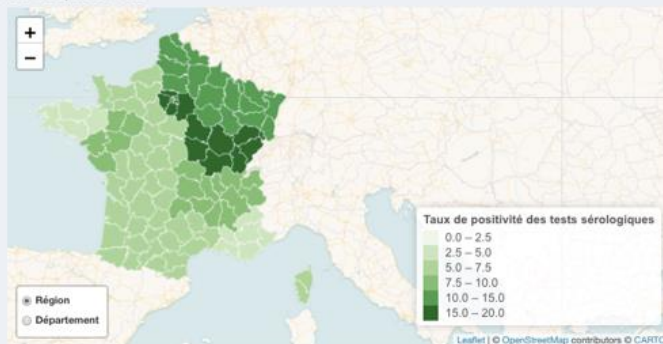

La liste des tests sérologiques disponibles sur le marché et répondant aux conditions posées par l'arrêté du 23 mars 2020 est consultable sur le site : <https://covid-19.sante.gouv.fr/tests>. Cette liste est mise à jour régulièrement.

Avertissement : les données suivantes sont issues de la base DREES et SIDEPA, ainsi que des réunions avec les ARS, des laboratoires d'analyse et industriels. Elles sont non exhaustives et confidentielles. Le bon renseignement de la base DREES est essentiel pour les travaux de la cellule nationale tests.