

Guide utilisateur – Remontée des stocks de dispositifs médicaux sur AtlaSanté

1. Connexion à la plateforme


Connectez-vous à la plateforme avec vos identifiants AtlaSanté.
Attention, seul le Chef de centre peut effectuer la déclaration de stocks de DM



Effectuer une déclaration de stocks de DM


1. Choix du centre de vaccination

Rechercher votre centre de vaccination en cliquant sur un point sur la carte ou en utilisant la barre de recherche

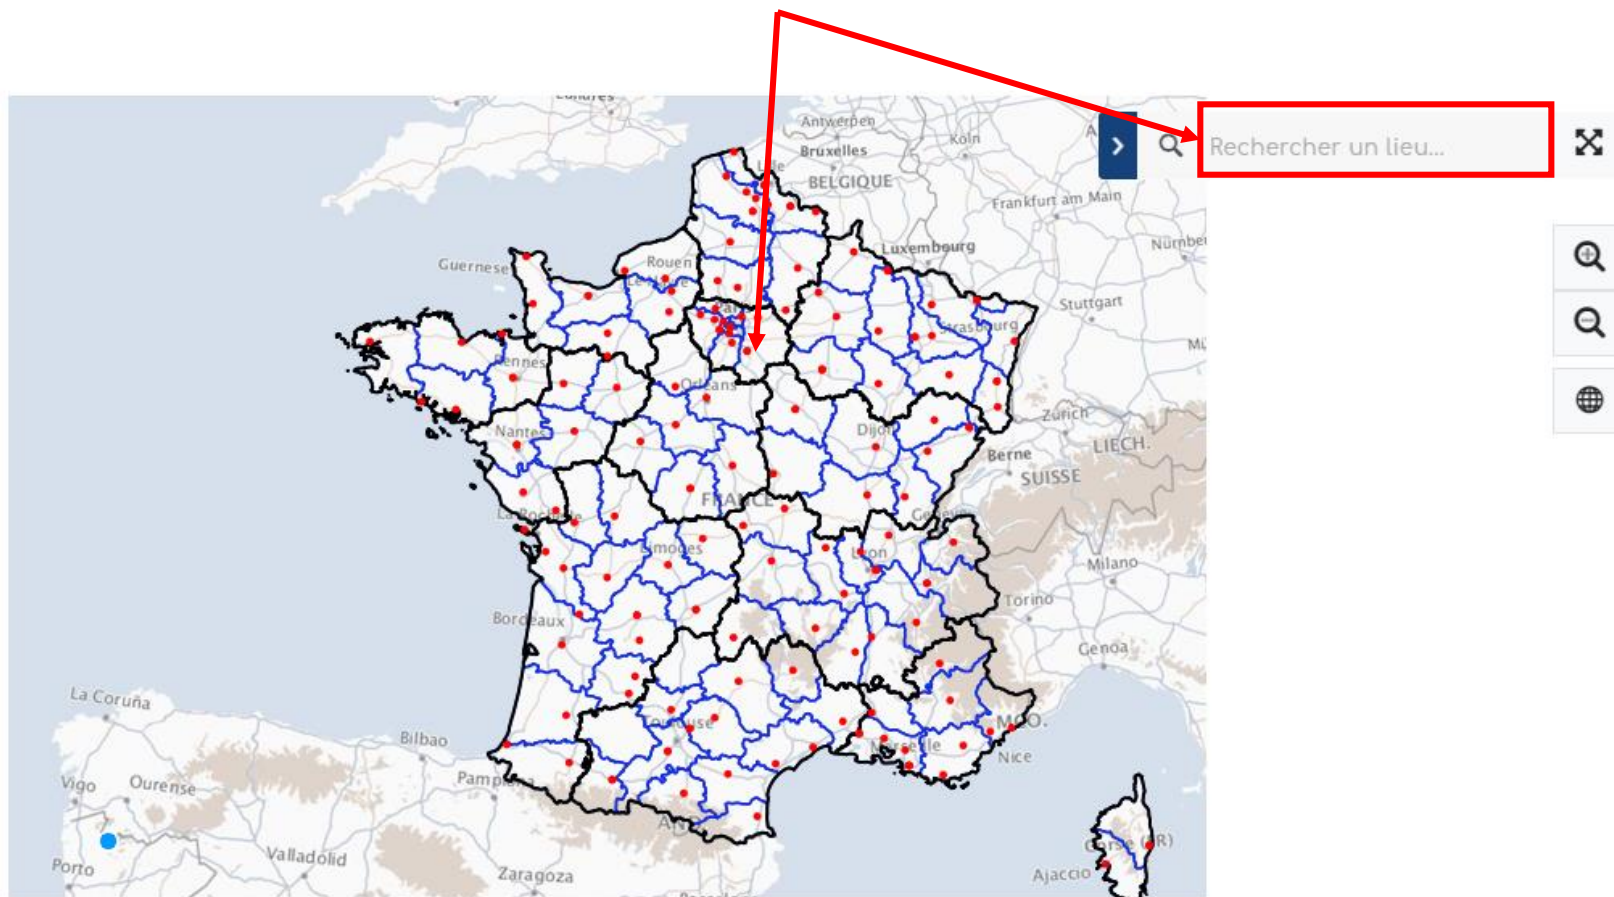

2. Déclaration des stocks de DM

Une fois votre centre trouvé, cliquer sur Déclaration Stocks DMs

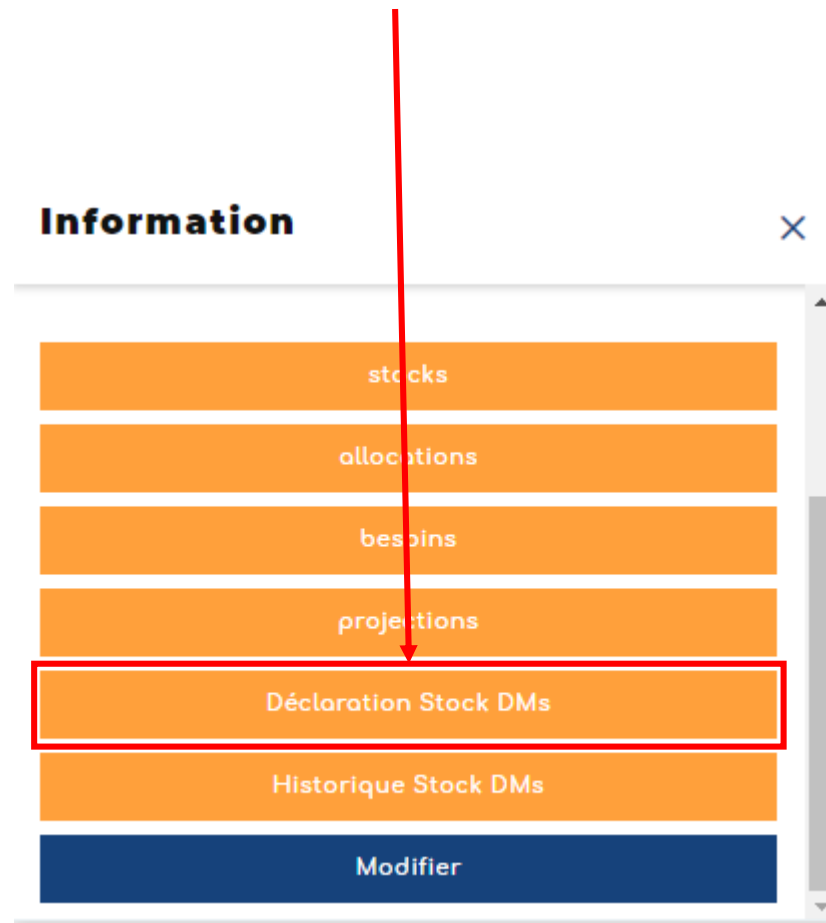

DÉCLARATION STOCK DM

« 1 »

2. Déclaration des stocks de DM

Saisir, pour chaque catégorie de DM, votre niveau de stock en sommant les quantités unitaires de chaque DM inclus dans la catégorie

DÉCLARATION STOCK DM

1 Déclaration
2 Validation

Kit administration 25mm * ? 0	Kit administration 16mm * ? 0	Aiguilles administration 16mm * ? 0
Aiguilles administration 25mm * ? 0	Aiguilles administration 30mm * ? 0	Seringue 1ml administration * ? 0
Kit de reconstitution * ? 0	Aiguille reconstitution ou administration 40mm * ? 0	Seringue reconstitution * ? 0
Chlorure de sodium * ? 0	Commentaire	

Vous pouvez cliquer sur les « ? » pour avoir le détails des DM attendus dans chaque catégorie

Si besoin, vous pouvez écrire un commentaire à destination de SpF pour apporter des précisions sur votre état de stocks

Attention:

Aucune quantité de DM ne doit être vide
→ Si vous n'avez pas de stock, saisir 0

Vous ne pouvez saisir que des nombres entiers (pas de nombre à virgule)

2. Déclaration des stocks de DM

DÉCLARATION STOCK DM

1 Déclaration
2 Validation

Kit administration 25mm * ? 100000	Kit administration 16mm * ? 0	Aiguilles administration 16mm * ? 0
Aiguilles administration 25mm * ? 0	Aiguilles administration 30mm * ? 0	Seringue 1ml administration * ? 0
Kit de reconstitution * ? 0	Aiguille reconstitution ou administration 40mm * ? 30000	Seringue reconstitution * ? 30000
Chlorure de sodium * ? 30000	Commentaire Kit administration compatibles 7 doses: 70000 ; kit administration non compatibles 7 doses: 30000	

Etape suivante

Une fois la saisie des stocks terminée, cliquer sur le bouton « Etape suivante »

3. Validation de la Déclaration des stocks de DM

DÉCLARATION STOCK DM

1 Déclaration

2 Validation

Cliquez sur le bouton « Modifier » pour effectuer une modification des stocks saisis

1 Déclaration

Kit administration 25mm 100000	Kit administration 16mm 0	Aiguilles administration 16mm 0
Aiguilles administration 25mm 0	Aiguilles administration 30mm 0	Seringue 1ml administration 0
Kit de reconstitution 0	Aiguille reconstitution ou administration 40mm 30000	Seringue reconstitution 30000
Chlorure de sodium 30000	Commentaire Kit administration compatibles 7 doses: 70000 ; kit administration non compatibles 7 doses: 30000	lieu 1512

Modifier

Terminer

Cliquez sur le bouton « Terminer » pour officialiser votre saisie et la transmettre à SpF

Attention: si vous ne cliquez pas sur terminer, la déclaration ne sera pas transmise à SpF

3. Validation de la Déclaration des stocks de DM

DÉCLARATION STOCK DM

	Kit administration 25mm	Kit administration 16mm	Aiguilles administration 16mm	Aiguilles administration 25mm	Aiguilles administration 30mm	Seringue 1ml administration	Kit de reconstitutic
Modifier	100000	0	0	0	0	0	0


Le récapitulatif de votre dernière déclaration est disponible ici.

Vous pouvez modifier votre déclaration autant de fois que nécessaire pendant le créneau d'ouverture des déclarations de stocks de DM → Pour cela, recommencer à l'étape 3.


**Accéder à l'historique des déclarations de
stocks de DM**

1. Choix du centre de vaccination

Rechercher votre centre de vaccination en cliquant sur un point sur la carte ou en utilisant la barre de recherche

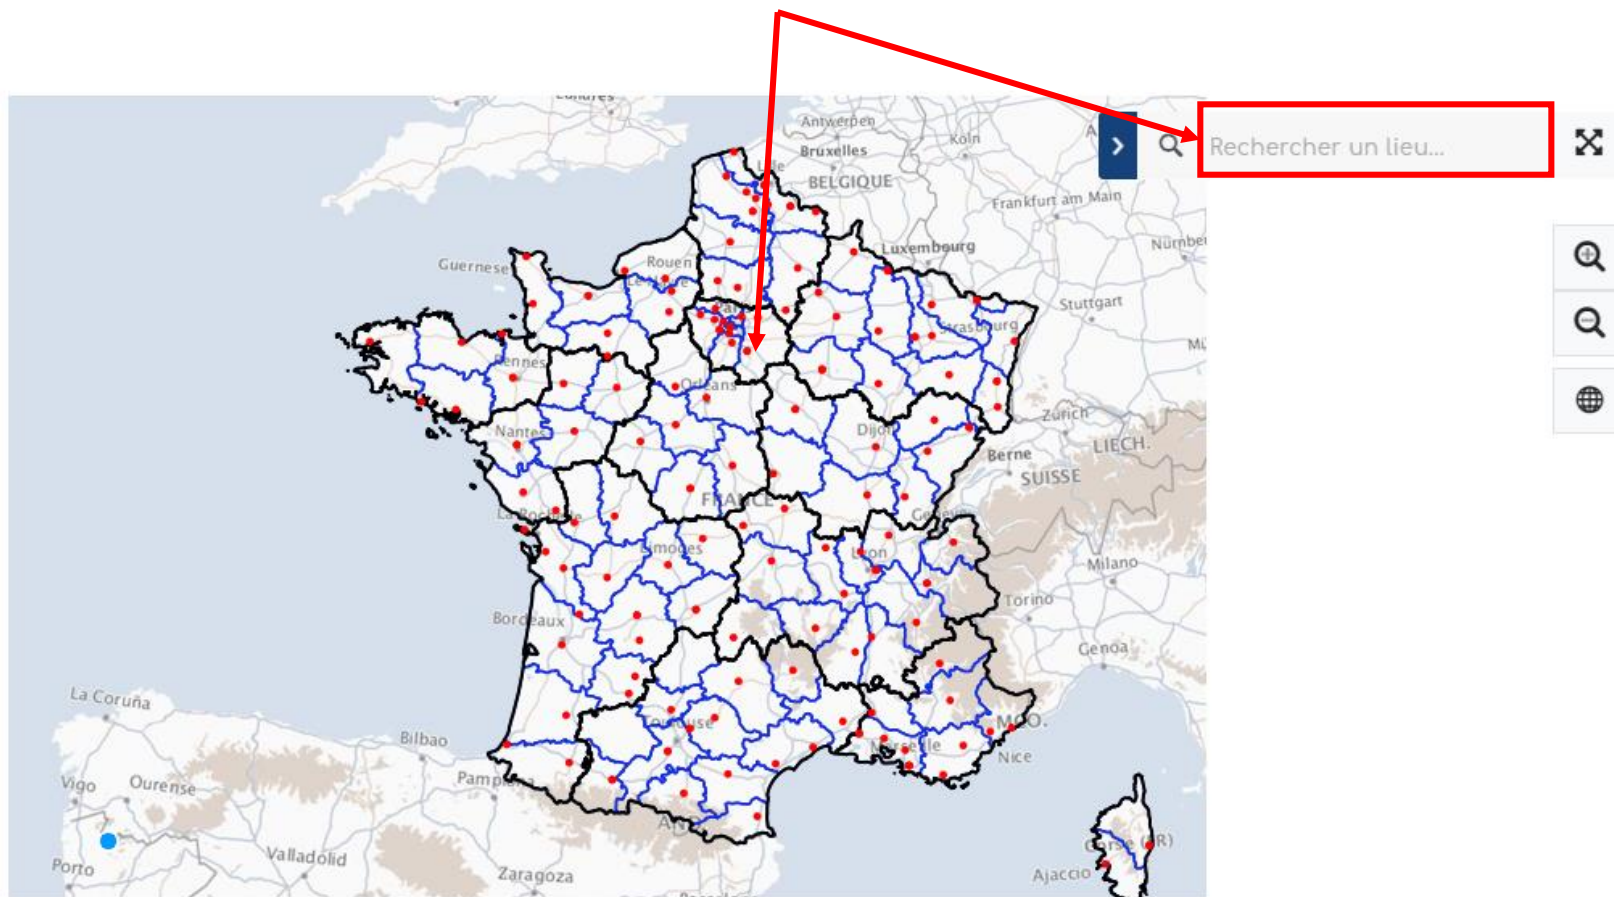

2. Accéder à l'historique des Déclarations de stocks de DM

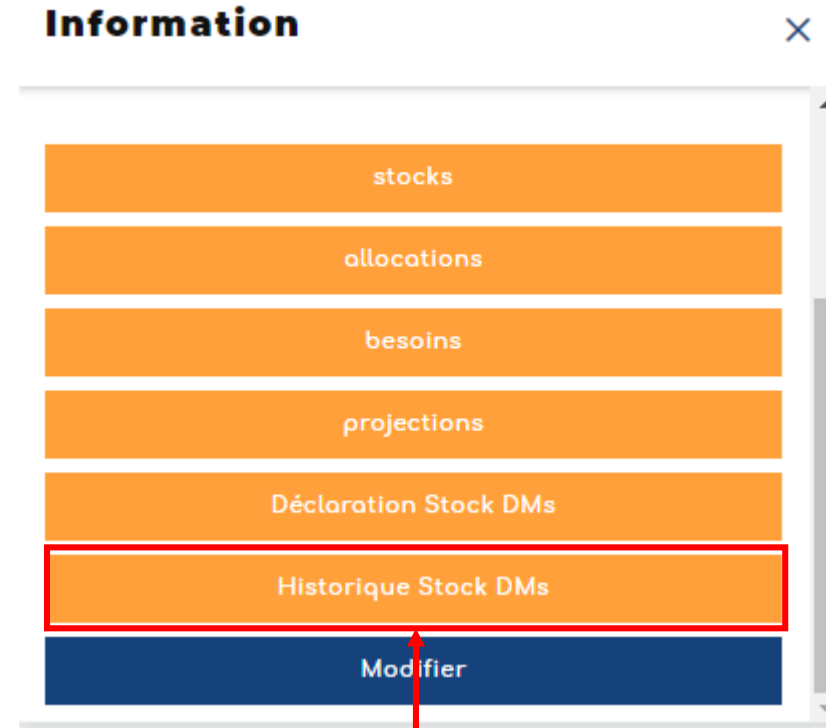

Cliquer sur « Historique Stock DMs »

2. Accéder à l'historique des Déclarations de stocks de DM

HISTORIQUE STOCK DM

Date de mise à jour ↑↓	Kit administration 25mm ↑↓	Kit administration 16mm ↑↓	Aiguilles administration 16mm ↑↓	Aiguilles administration 25mm ↑↓	Aiguilles administration 30mm ↑↓	Seringue 1ml administration ↑↓	Kit de reconstitu
2021/05/26 11:48:57.707	23000	250	5000	0	237	0	4000

« 1 »

5 ↕

L'ensemble de vos déclarations validées sont disponibles ici.
Il n'est pas possible de modifier une déclaration dans l'historique